
MONICOR

Systeme d'analyse et de therapie
par biorésonance



MONICOR

Le MONICOR est un système unique pour l'analyse de la santé mais permet également des corrections efficaces basées sur le principe de la biorésonance.

Issu de la recherche et de la pratique Russe, développé par les créateurs du Triomed et de l'Aquatone, le Monicor est un système complet d'analyse et de thérapie par biorésonance qui permet de mieux comprendre l'état de santé des organes, des systèmes du corps et des méridiens d'acupuncture. Il permet également de détecter et de traiter de nombreux parasites, ainsi que d'évaluer l'adéquation de différents suppléments et nutriments pour un sujet donné. Il permet enfin d'évaluer l'efficacité d'autres types de traitement en temps réel.

Le Monicor est intégrée dans la pratique médicale en Russie, utilisée par les cosmonautes et, grâce à son efficacité élevée et à sa facilité d'utilisation, a reçu de nombreux prix et récompenses en Russie et dans d'autres pays.

Principes de fonctionnement

En quelques minutes, l'appareil scanne l'ensemble du corps et de tous ses organes et présente l'état fonctionnel et le niveau de stress de ceux-ci.

Le corps humain n'est pas seulement un être physique, il est aussi composé d'une structure énergétique et d'informations détaillées. Chaque organe et chaque partie du corps a ses propres vibrations, qui sont reflétées dans les paramètres biochimiques des organes respectifs. En effectuant une analyse de ces informations énergétiques, le Monicor permet d'évaluer l'état de santé des organes, des systèmes et des méridiens d'acupuncture.

Le corps est composé de divers organes, glandes, etc., qui forment un réseau, qui est régi par le système nerveux, le système hormonal et le système des méridiens, tous protégés par le système immunitaire. Dans une large mesure, notre santé dépend du bon fonctionnement de ces systèmes. Le Monicor est capable de corriger efficacement tous ces systèmes.

- Les suppléments, les légumes, les fruits et toutes sortes d'aliments ont leurs fréquences. L'appareil est, par résonance, capable de détecter l'adéquation de différents suppléments et nutriments.
- Le programme du Monicor reconnaît les fréquences d'une majorité des parasites existants et est capable de détecter si ceux-ci existent dans le corps. Si c'est le cas, le Monicor est capable d'éliminer ces parasites en appliquant les bonnes fréquences.

- L'appareil est également capable de lire les fréquences des points d'acupuncture et de montrer les points faibles. En choisissant les points les plus faibles et en les corrigeant, nous sommes en mesure d'offrir un traitement d'acupuncture optimal. L'appareil est capable de choisir le bon traitement en sélectionnant un symptôme réel et de calculer les zones ou les points à traiter.
- Enfin le Monicor est capable d'analyser l'efficacité de différents types de traitements comme la réflexologie, le Triomed ou l'Aquatone, en temps réel. Il est également capable de montrer comment les fréquences technogènes dans une pièce, comme le wifi ou les micro-ondes, affectent vos organes et vos systèmes.

Prix et récompenses



Médaille pour contribution au développement de l'astronautique



Médaille pour contribution au développement et innovation dans les soins de santé



Médaille de l'Académie européenne

Guide rapide d'utilisation

Le MONICOR est un système unique pour évaluer sa santé mais permet également des corrections efficaces basées sur le principe de la biorésonance. La biorésonance est la façon ultime de corriger les dysfonctions car elle restaure les fonctions normales du corps sans les modifier, ce qui aide à guérir le corps de façon naturelle.

Le Monicor peut être utilisé de plusieurs façons :

Équilibrer les méridiens

Avoir des méridiens équilibrés est d'une importance vitale pour notre santé. Le MONICOR détecte s'il y a un surplus ou un manque d'énergie dans les méridiens. Pendant une correction générale de 40 minutes, généralement 1-2 méridiens sont restaurés (par session).

Correction des points d'acupuncture

Le MONICOR détecte et active tous les points d'acupuncture faibles dans le corps. Il montre également quels points sont normaux. Pendant une correction générale de 40 minutes, tous les points d'acupuncture sont corrigés.

Test de stress

Le MONICOR lit les fréquences d'environ 170 micro-organismes différents, tels que les virus, les bactéries et les parasites. Si l'un de ces micro-organismes est actif, le MONICOR est capable de les désactiver en utilisant les fréquences appropriées. Un micro-

organisme est généralement activé lorsque le corps est affaibli ou porte des stagnations. Les virus et les parasites captés à l'extérieur peuvent également affecter le corps.

Vérification de l'effet des suppléments et des aliments

Le MONICOR a une capacité unique de vérifier comment un certain organe ou système corporel est affecté par divers suppléments et aliments.

La correction des symptômes

Avec cette fonction, le MONICOR utilise un symptôme spécifique comme base et calcule quels zones ou points d'acupuncture doivent être corrigés.

Consignes importantes

- Ne pas manger deux heures avant une évaluation diagnostique et une correction
- Afin d'obtenir un bon flux d'énergie, faire asseoir le client avec le dos droit
- Enlever les montres et les bracelets
- Ne pas croiser les bras ou les jambes ou les rapprocher
- Ne pas effectuer de corrections pendant les deux premiers mois d'une grossesse
- Dans l'évaluation diagnostique, le MONICOR vous montrera quels organes sont stressés à ce moment-là. Vous devez effectuer plusieurs évaluations de diagnostic par la suite pour voir, par exemple si un organe est encore stressé. Il est cependant important de faire une pause de 24 heures entre les évaluations diagnostiques.
- Il n'est pas rare de ressentir de la fatigue ou de la somnolence après le traitement. Dans certains cas, des vertiges, des nausées, de la transpiration ou une baisse de la tension artérielle peuvent survenir.
- Manipulez les cordons et les prises avec précaution pour éviter les connexions défectueuses.
- Pour obtenir un contact optimal entre la peau et les pinces, humidifier un coton-tige d'env. 12 mm avec une solution saline

(NaCl 09%), disponible en pharmacie. Rouler le coton-tige en petite boule et placez le sur la surface métallique de la pince.

Identification et traitement des points clé

L'emplacement du point clé est indiqué avec un point ROUGE sur les mains ou les pieds, voir l'exemple ci-dessous.



Figure 1
Représentation d'un point clé dans le logiciel.

Dans l'image, vous verrez (s) ou (d), ce qui signifie la main ou le pied gauche (s) ou droit (d).

Ne surtraitez pas un point clé, car il peut devenir épuisé. Le temps de traitement recommandé est max. 60 minutes par 24 heures.

Scan/calibration

Avant de lancer une évaluation, le MONICOR mesurera les caractéristiques de l'environnement électromagnétique pendant env. 1 minute. Cette analyse est effectuée afin de normaliser un effet environnemental potentiel sur le client.

Ceci est fait une fois toutes les heures lorsque le MONICOR est allumé, et signifie qu'une analyse supplémentaire pourrait être nécessaire si la session dure plus d'une heure.

NB: Lors de ce scan, il est important qu'aucun cordon ne soit en contact avec le client!

L'unité d'enregistrement

Une unité d'enregistrement est fournie avec le MONICOR et est utilisée pour la correction des symptômes et le test de stress. Peu importe le côté de l'unité d'enregistrement que vous utilisez. Vous pouvez enregistrer sur une ou plusieurs bandes magnétiques, sur l'eau ou sur les huiles étherées.

Bandes magnétiques

Dans la phase de correction d'un symptôme, il est possible de programmer plusieurs bandes magnétiques en même temps. Les bandes magnétiques doivent ensuite être collées à l'emplacement des symptômes et / ou à l'intérieur des deux poignets, au point MC7 - le point universel (voir Figure 2).

Les bandes magnétiques, de 1 à 1,5 cm de largeur, peuvent être laissées sur les points pendant env. 6 à 8 heures. Par la suite laissez

le corps se reposer jusqu'au jour suivant, avant de remettre les bandes.

Vous ne devez pas utiliser des bandes magnétiques pour des corrections différentes en même temps. Vous ne devez pas non plus mélanger des bandes magnétiques de correction de symptôme avec des bandes de correction de stress.

Le recyclage des bandes magnétiques n'est possible que pour la correction des symptômes. Pour les tests de résistance des virus, des bactéries et des parasites, les bandes magnétiques doivent être jetées après la correction effectuée ou après que le résultat souhaité ait été atteint.

Eau, lotions ou huiles

Il est conseillé de placer de temps en temps un verre d'eau sur l'unité d'enregistrement et d'en boire une gorgée de temps en temps. Gargarisez avant d'avaler l'eau.

Huile éthérique

Pour renforcer l'effet de la correction, placez une bouteille d'huile éthérique sur l'unité d'enregistrement, puis appliquez l'huile sur le corps. La programmation dans l'huile éthérique durera longtemps.

Evaluation diagnostique

Lorsque vous effectuez une évaluation diagnostique, vous verrez, en temps réel, 1 170 conditions de stress différentes dans le corps, l'état du système méridien, les risques potentiels de maladie, les virus et parasites actifs, etc. Vous verrez également là où il y a une activité anormale (trop ou pas assez) dans les différents systèmes du corps.

Attention: avant que l'évaluation ne commence, le MONICOR va se calibrer et il le fera une fois toutes les heures. Pendant ce processus, aucun cordon ne doit être relié au client!

Utilisez le cordon DIN, qui doit déjà être branché sur l'unité MONICOR. Afin d'obtenir un résultat correct, il est important d'utiliser le bon cordon et que les cordons rouge et noir soient connectés à la pince et au poignet correspondant.

Positionnement des électrodes

- Placer un coton-tige légèrement humidifié d'env. 12 mm sur la surface métallique des pinces crocodile.
- Placer la surface métallique de la pince crocodile ROUGE à l'intérieur du poignet gauche du client (MC7) avec le rabat vers l'extérieur.
- Placez la surface métallique de la pince crocodile NOIRE sur l'intérieur du poignet droit du client (MC7) avec le rabat vers l'extérieur.

- Connectez un cordon DIN rouge à la pince crocodile rouge.
- Connectez un cordon DIN NOIR (VERT) à la pince crocodile NOIRE.
- Appuyez légèrement sur les pinces crocodiles pour créer un contact optimal. Ensuite, branchez le cordon à la prise DIN ronde sur le MONICOR.

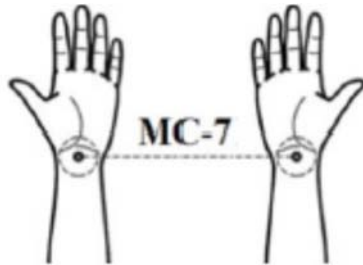


Figure 2
Emplacement des points MC-7

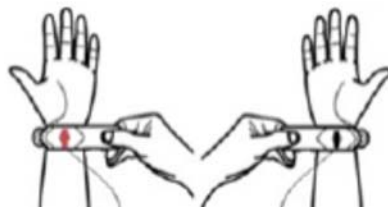


Figure 3
Placement des pinces crocodiles pour le diagnostic / test de stress. Rouge à gauche et Noir sur le poignet droit

Evaluation diagnostique étape par étape

Pour obtenir une évaluation diagnostique optimale, demandez au client de se tenir droit et, si possible, seul dans la pièce. L'évaluation prend 110 secondes à effectuer. Il est important de ne faire qu'une évaluation diagnostique par période de 24 heures afin de ne pas épuiser les points de mesure dans le corps.

Attention: N'effectuez PAS d'évaluation diagnostique après une correction car cela épuise les points de mesure du corps.

- Fixez les pinces crocodiles, (voir ci-dessus)
- Sélectionnez *Client* et ensuite *Examinations* (Examens)
- Vérifier le Diagnostic différentiel
- Cliquez sur *Start* (Démarrer) *MONICOR*

Test de produits

Attention: avant que l'évaluation ne commence, le MONICOR va se calibrer et il le fera une fois toutes les heures. Pendant ce processus, aucun cordon ne doit être relié au client!

Utilisez le cordon DIN, qui doit déjà être branché sur l'unité MONICOR. Afin d'obtenir un résultat correct, il est important d'utiliser le bon cordon et que les cordons rouge et noir soient connectés à la pince et au poignet correspondant.

Positionnement des électrodes

- Placer un coton-tige légèrement humidifié d'env. 12 mm sur la surface métallique des pinces crocodile.
- Placer la surface métallique de la pince crocodile ROUGE à l'intérieur du poignet gauche du client (MC7) avec le rabat vers l'extérieur.
- Placez la surface métallique de la pince crocodile NOIRE sur l'intérieur du poignet droit du client (MC7) avec le rabat vers l'extérieur.
- Connectez un cordon DIN rouge à la pince crocodile rouge.
- Connectez un cordon DIN NOIR (VERT) à la pince crocodile NOIRE.
- Appuyez légèrement sur les pinces crocodiles pour créer un contact optimal. Ensuite, branchez le cordon à la prise DIN ronde sur le MONICOR.

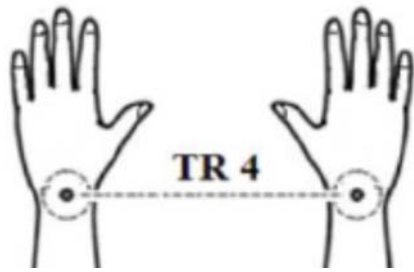


Figure 4
Emplacement des points TR4
pour le test des produits

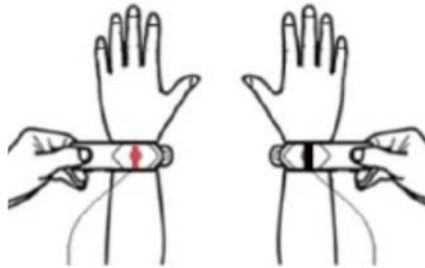


Figure 5
Placement des pinces crocodiles
lors du test de produit. Rouge à
gauche et Noir sur le poignet
droit.

Test de produits étape par étape

Ce test est idéal pour évaluer comment un supplément ou certains aliments peuvent affecter le corps. Il est fortement recommandé de ne pas faire plus de 5 tests par période de 24 heures car cela affaiblirait les points de mesure.

- Sélectionnez le client et cliquez sur *Examinations* (Examens)
- Cliquez sur *Preparations testing* (Examen de produits)
- Sélectionnez le nombre de produits dans le menu *Preparations number*

- Fixez les pinces crocodiles, (voir ci-dessus)
- Cliquez sur *Start* (Démarrer) *MONICOR*.

Test de stress

- Il est fortement recommandé de ne tester que 10 variables par période de 24 heures car en faire plus peut affaiblir le corps.
- Avant d'effectuer le test de stress, vous devez toujours effectuer une évaluation diagnostique différentielle
- Toujours effectuer un test de stress *avant* une correction générale
- Il est conseillé de ne pas parler pendant le test de stress, l'évaluation diagnostique ou la correction

Attention: avant que l'évaluation ne commence, le MONICOR va se calibrer et il le fera une fois toutes les heures. Pendant ce processus, aucun cordon ne doit être relié au client!

Utilisez le cordon DIN, qui doit déjà être branché sur l'unité MONICOR. Afin d'obtenir un résultat correct, il est important d'utiliser le bon cordon et que les cordons rouge et noir soient connectés à la pince et au poignet correspondant.

Positionnement des électrodes

- Placer un coton-tige légèrement humidifié d'env. 12 mm sur la surface métallique des pinces crocodile.
- Placer la surface métallique de la pince crocodile ROUGE à l'intérieur du poignet gauche du client (MC7) avec le rabat vers l'extérieur.

- Placez la surface métallique de la pince crocodile NOIRE sur l'intérieur du poignet droit du client (MC7) avec le rabat vers l'extérieur.
- Connectez un cordon DIN rouge à la pince crocodile rouge.
- Connectez un cordon DIN NOIR (VERT) à la pince crocodile NOIRE.
- Appuyez légèrement sur les pinces crocodiles pour créer un contact optimal. Ensuite, branchez le cordon à la prise DIN ronde sur le MONICOR.

Mise en place du cordon de son

- Placez l'électrode patch à l'intérieur du poignet gauche, point MC6
- Fixez le cordon audio ROUGE à l'électrode patch
- Placez un coton-tige légèrement humidifié d'environ 12. mm sur la partie métallique de la surface de la pince crocodile
- Placer une pince crocodile VERTE sur l'intérieur du poignet gauche, point MC5
- Fixez un cordon audio NOIR (VERT) à la pince crocodile VERTE

- Appuyez légèrement sur la pince crocodile pour assurer un contact optimal
- Fixez le cordon audio à la prise de votre ordinateur pour les écouteurs
- Vérifiez dans Windows que la prise pour les écouteurs a été sélectionnée

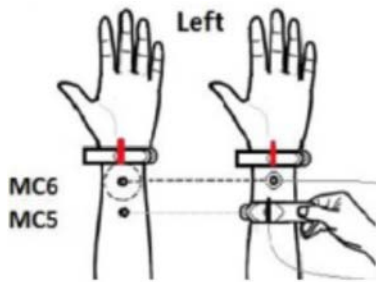


Figure 6
Positionnement de l'électrode sur le point MC6 et la pince crocodile sur l'avant-bras gauche (MC5)

Test de stress étape par étape

- Effectuez une évaluation diagnostique
- Sélectionnez le Client
- Cliquez sur *Result* (Résultat)
- Sélectionnez la date choisie et vérifiez l'heure sélectionnée, sinon une évaluation diagnostique différentielle sera effectuée

- Cliquez sur le bouton *Stress test*
- Sélectionnez max. 10 variables de la liste, voir les suggestions ci-dessous
- Fixez les pinces crocodiles, voir les instructions ci-dessus
- Cliquez sur *Start* (Démarrer) pour commencer le test de stress

Correction

Parfois, le temps de correction total peut être très long - plus de 60 minutes. Si c'est le cas, vous pouvez raccourcir le temps à 10 secondes / fréquence et également stocker les informations sur une bande magnétique que vous collez à l'intérieur du poignet, point MC7, pendant 6-8 heures en post-traitement.

- Si nécessaire, placez une bande magnétique, de l'eau ou de l'huile étherée sur l'unité d'enregistrement.
- Si nécessaire, changer le temps à 10 secondes (compression), sinon, 180 minutes est recommandé pour obtenir une correction en direct optimale
- Cliquez sur *Start* (Démarrer)

NB: La bande magnétique ne peut pas être recyclée, c'est-à-dire reprogrammée, après la programmation du test de stress.

Tests suggérés:

- Virus Adone (3)
- Borrelia / Borrelia spirochete (22)
- Chlamydia (35)
- Helicobacter (70)
- Herpès (77)
- Mycoplasmes (toux) (97-99)
- Babesia (11)
- Candida (28-29)
- Epstein Barr virus (50)
- Hepatite B (73)
- Legionella (Legionella) (88)
- Normalize the heart (normaliser le coeur)(109)
- Normalize the nervous system (normaliser le système nerveux) (114)
- Normalize the immune system (système immunitaire) (111)
- Normalize the pineal gland (glande pinéale) (115)

Correction générale

N'effectuez pas de correction générale avant d'avoir effectué un test de stress et / ou un test de produit. La correction des méridiens et des points d'acupuncture (points méridiens) est cruciale car elle améliore la circulation de l'énergie dans le corps et donc l'état général du corps, elle affecte également positivement les mécanismes de régulation du corps.

Astuce: En effectuant une correction générale pendant au moins 40 minutes, tous les points d'acupuncture nécessitant une correction seront corrigés. S'il y a de grands déséquilibres, vous pouvez facilement effectuer une correction de 40 minutes une fois par jour.

Attention: avant que l'évaluation ne commence, le MONICOR va se calibrer et il le fera une fois toutes les heures. Pendant ce processus, aucun cordon ne doit être relié au client!

Utilisez le cordon DIN, qui doit déjà être branché sur l'unité MONICOR. Afin d'obtenir un résultat correct, il est important d'utiliser le bon cordon et que les cordons rouge et noir soient connectés à la pince et au poignet correspondant.

- Placez une électrode patch sur le point clé comme indiqué dans le programme MONICOR (voir Figure 1).
- Placez une pince crocodile / alligator sur l'un des points MC7 ou, par exemple, sur une épaule douloureuse (voir Figure 2).
- Fixez le cordon DIN à une électrode patch.

Temps de correction suggérés

Enfants (-15): 10 minutes, intervalle 3-5 minutes, 5-7 corrections puis pause 5-7 jours

Adultes (15+): 30-60 minutes, intervalle 5-8 minutes, 10-12 corrections puis pause 7- 10 jours

Personnes âgées (60+): Identique à l'adulte mais avec 12-15 corrections, puis une pause de 7 à 12 jours

Correction générale étape par étape

- Sélectionnez le client et cliquez sur *Examinations* (Examens)
- Définir le temps de correction selon les temps de correction suggérés ci-dessus dans le champ *Time* (11)
- Définir une intervalle selon les intervalles suggérées ci-dessus dans le champ *Stages of Iteration* (Etapes d'itération) (4)
- Vérifier la correction
- Fixez les pinces crocodiles, voir les instructions précédentes
- Cliquez sur Start (Démarrer)

Attention: Dans cette section vous ne pouvez pas utiliser l'unité d'enregistrement car la correction générale est toujours faite en direct!

Correction des symptômes

Il n'est pas nécessaire d'effectuer une évaluation diagnostique avant la correction de symptômes. Vous pouvez choisir entre deux méthodes :

1. Correction en direct par électrodes et programmation de bandes magnétiques
2. Programmation uniquement de bandes magnétiques pour une correction à base d'aimant.

Note: Pour la correction des symptômes, il est possible de programmer plusieurs bandes magnétiques en même temps, puis de les coller sur différents points de symptômes et les deux poignets MC7, les points universels. Les bandes magnétiques peuvent être recyclées, c'est-à-dire reprogrammées lors d'une session ultérieure.

Attention: avant que l'évaluation ne commence, le MONICOR va se calibrer et il le fera une fois toutes les heures. Pendant ce processus, aucun cordon ne doit être relié au client!

Utilisez le cordon DIN, qui doit déjà être branché sur l'unité MONICOR. Afin d'obtenir un résultat correct, il est important d'utiliser le bon cordon et que les cordons rouge et noir soient connectés à la pince et au poignet correspondant.

Positionnement des électrodes

- Placez une électrode patch ou une pince crocodile sur le point de poignet gauche MC7
- Placer une électrode patch ou une pince crocodile sur le point MC7 du poignet droit ou sur, par exemple, une épaule douloureuse.
- Connectez les 2 cordons DIN à tous les patches ou pinces crocodile.

La correction des symptômes étape par étape


- Démarrer le programme MONICOR
- Vous n'avez pas besoin de sélectionner un client
- Cliquez sur le programme *Conditions correction by symptom complexes* (Correction des symptômes) en bas à gauche

Conditions correction by symptom complexes

- Cliquez sur *ON*, tapez par exemple Candida et cliquez *Search* (Rechercher) pour voir les liste des options.
- Cochez vos options de recherche dans la liste

Schems	
Name	S...
Candida	<input type="checkbox"/>
Candida car	<input checked="" type="checkbox"/>
Increasing immunity in the Candida	<input checked="" type="checkbox"/>
Increasing immunity in the Candidas + Helmintes	<input checked="" type="checkbox"/>

- Si vous voulez voir les points d'acupuncture pour une personne, cochez le sexe de la personne (au milieu à droite de l'écran) et cliquez sur *Correction*.
- Cliquez sur la case *Edit schema* (Modifier le schéma) et sélectionnez le temps et la fréquence maximum. Nous recommandons 180 secondes (3 minutes) pour obtenir une correction optimale. Vous pouvez également sélectionner 10 secondes pour programmer une bande magnétique pour la correction des symptômes, voir l'image ci-dessous:

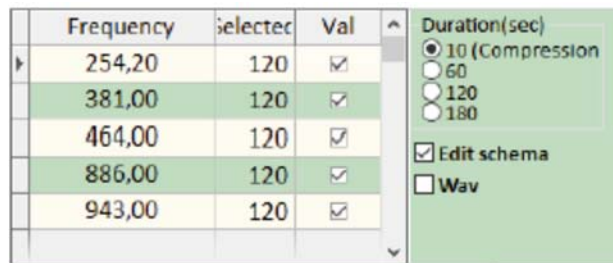

- Placer une bande magnétique dans le "programmeur" et / ou attacher les électrodes puis cliquer sur *Start* (Démarrer) pour commencer.
- Lorsque vous avez terminé la programmation de la bande magnétique, placez la bande magnétique sur le point MC7 d'un des deux poignets. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Unité d'enregistrement" de ce document.

Découvrez aussi sur Xede Store

L'AQUATONE



Appareil de thérapie par ondes de résonance UHF

Le principe de l'Aquatone, dont l'efficacité a été testée et prouvée par de nombreux organismes, dont notamment l'Institut Karolinska à Stockholm et l'Université de Harvard à Boston aux Etats-Unis, est d'agir par ondes de résonance pour rétablir une bonne communication intracellulaire dans le corps, grâce aux effets des ondes de ce type sur les molécules d'eau présentes dans le corps.

Cet appareil très simple à utiliser et totalement non-invasif va émettre à très faibles doses les fréquences vibratoires qui vont réorganiser les clusters de molécules d'eau dans notre corps, rétablissant une bonne communication intracellulaire. L'Aquatone va moduler les fréquences et les coupler avec des résonances spécifiques aux organes, afin de permettre de cibler des problèmes

ou des désordres particuliers. En quelque sorte, l'Aquatone agit comme un diapason pour rétablir l'harmonie dans le corps.

La recherche et les essais cliniques ont démontré l'efficacité de l'Aquatone dans le traitement de

- maladies du système genito-urinaire telles que la cystite et la prostatite.
- maladies du système cardio-vasculaire (hypertension, ischémie cérébrale chronique)
- maladies inflammatoires du système respiratoire (bronchite, pneumonie), maladies ORL (sinusite, adénoïdite, surdité)
- maladies du système digestifs (gastrite, ulcère gastrique ou duodénale), maladies de la peau (eczéma, scléroderma), maladies des articulations (arthrite, ostéoarthrite), ligaments endommagés)
- maladies des systèmes central et périphéral nerveux, dans la réhabilitation suite à un AVC ou une crise cardiaque, mais également dans les cas de travail physique ou d'exercice intense.

www.aquatone.fr

L'APPLICATION GENIUS INSIGHT



La nouvelle génération d'application mobile pour l'analyse et la thérapie quantique

Une analyse et un rééquilibrage de votre champ énergétique simple et intuitif.

Analysez et ré-équilibrez les paramètres essentiels des champs énergétiques de votre corps.

Basée sur la technologie avancée du système LIFE, l'application **Genius Insight** représente une nouvelle génération plus abordable de cette technologie, et vous propose une expérience d'analyse et de correction énergétique riche, moderne et très facile à utiliser.

Fournit un scan énergétique complet basé sur votre empreinte vocale unique et votre image

Compare votre empreinte vocale avec la base de données Genius, qui contient des milliers de fréquences et signatures énergétiques

Décèle les déséquilibres potentiels dans votre corps et vous propose des solutions de rééquilibrage de votre champ énergétique

En commençant par une analyse complexe de votre signature vocale, qui est comparée à des milliers de fréquences énergétiques dans la base de données du logiciel Genius, en passant par l'intégration des signaux 'Binaural Beats' pour faciliter l'assimilation des fréquences correctives par le corps, ou encore par la possibilité d'interagir avec la communauté de praticiens et d'utilisateurs, le Genius vous ouvre désormais de nouveaux horizons dans l'analyse et la thérapie énergétique quantique.

Le biofeedback pour tout le monde!

Avec cette application très complète, l'analyse et la correction deviennent toutefois simples et fascinantes. Le manuel détaillé vous fournira une introduction aux thérapies quantiques et des instructions faciles à suivre. Vous apprendrez rapidement comment mesurer, analyser et corriger vos énergies physiques, émotionnelles et mentales, et vous vous trouverez très vite passionné par cette nouvelle technologie alternative, naturelle et efficace, qui est de plus en plus utilisée dans le monde entier.

www.geniusinsight.fr

LES GELS HYPEROXYGENES KAQUN



Issus de la recherche scientifique Hongroise, et basés sur l'eau Kaqun à très haute concentration en oxygène, les gels KAQUN Natural et Gold apportent une solution 100% naturelle et extraordinairement efficace à tous les problèmes de peau. Ils permettent d'augmenter de façon très significative l'apport d'oxygène à la peau, grâce à une modification moléculaire de l'oxygène qui rend l'oxygène plus facilement assimilable par la peau et évite toute perte par évaporation.

Grâce à l'oxygène, le métabolisme de la peau se renouvelle, et elle retrouve la magie de sa jeunesse. Le gel peut être particulièrement efficace contre les problèmes persistants - acné, rougeurs, abrasions, tâches de vieillesse et autres dégénérescences du derme. L'absence de tout produit chimique ou artificiel fait qu'il convient à tous types de peau.

Le gel Kaqun existe sous deux formes:

- le gel Natural, sans parfum et sans colorant, dans un tube doseur de 75ml. Il contient aussi xqh#frp e lqdlvrq#gh#45# dxwuhv#sulqflshv#dfwlv#how#txh#sdqwkýqrp /#|vlqh/#duj lq lqh#hw# dædqwrqjh#srxu#dlghu#yrwuh#shdx#ú#p dlqwhql#vrq#wrxfkhu# vr |hx {#hw#qjh# |gudwdwrq#sur irqgh

oet le gel Gold, en tube de 50ml, qui contient aussi de l'or 24 carats en suspension, reconnu depuis le début des temps pour ses effets bienfaisants sur la peau.

Hilfdfh#Frqwuh##

- Taches de vieillesse, rides et ridules
- Rougeurs
- Acné
- Fatigue de la peau
- Brûlures
- Lésions et coupures

www.gel-kaqun.fr



**Solutions et technologies innovantes
pour la santé et le bien-être**

xedestore.com